

REF 6001

Poliravimo Padas

Naudojimas pagal paskirtį

Poliravimo padas, skirtas naudoti su standžiaisiais endoskopais, turi poliravimo paviršių, padedantį sumažinti nešvarumus nuo lęšio.

Įspėjimai

- Naudokite tik su standžiaisiais endoskopais.
- NENAUDOKITE ant labai įkaitusių paviršių.
- NENAUDOKITE su cheminėmis medžiagomis ar tirpikliais.
- NEMODIFIKUOKITE poliravimo padų.
- NELENKITE endoskopo poliravimo metu.

Įvykus incidentui

Bet koks rimtas incidentas, susijęs su šiuo prietaisu, turi būti praneštas gamintojui ir atitinkamai valstybės narės institucijai, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas.





Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

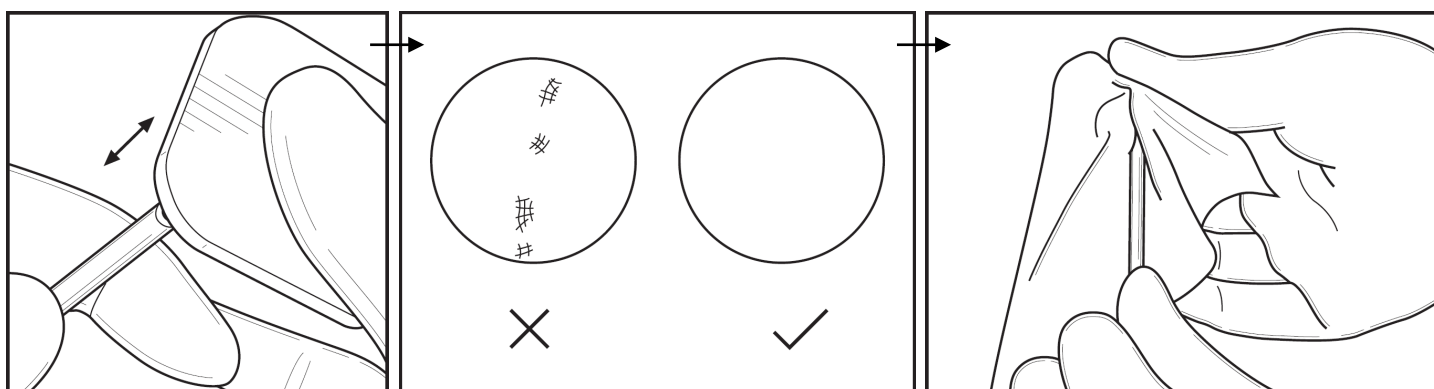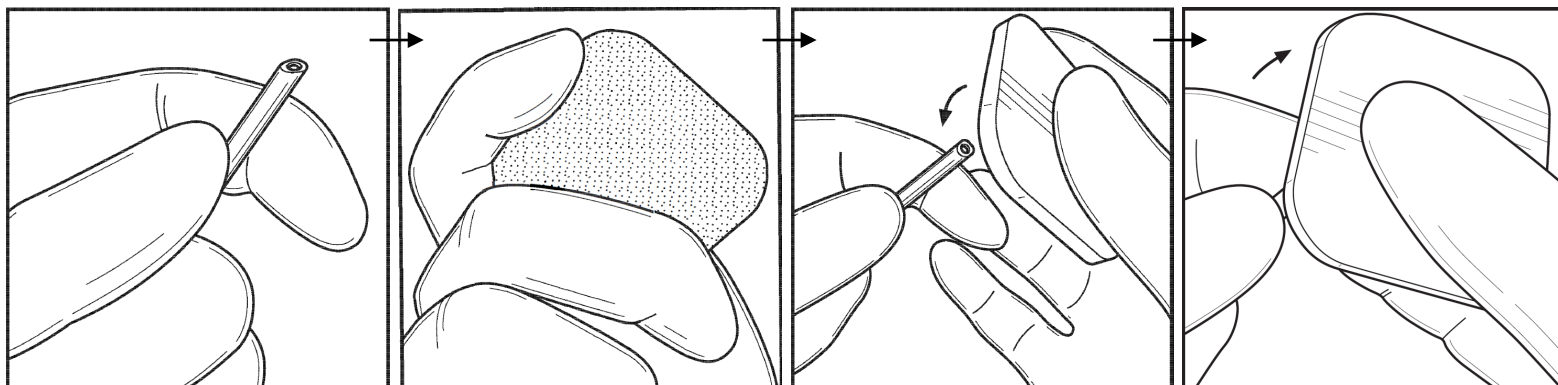

Pasirinktina

