

REF 6001

Polírozó párna

Rendeltetésszerű használat

A merev szárú endoszkópokhoz tervezett, polírozó párna felülete segít csökkenteni a lencsén lerakódó szennyeződések.

Figyelmeztetések

- Kizárólag merev szárú endoszkópokkal használható.
- NE használja nagyon forró felületeken.
- NE használja vegyszerekkel vagy oldószerekkel.
- NE végezzen módosításokat a párnákon.
- NE hajlítsa meg a csövet csiszolás közben.

Baleset esetén

A készülékkel kapcsolatos bármely súlyos balesetet be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak a illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg lakik.

Ártalmatlanítás

Az egészségügyi intézményi és helyi kormányzati iránymutatások szerint kell ártalmatlanítani.



Domicomed.com/eifu





Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Málta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

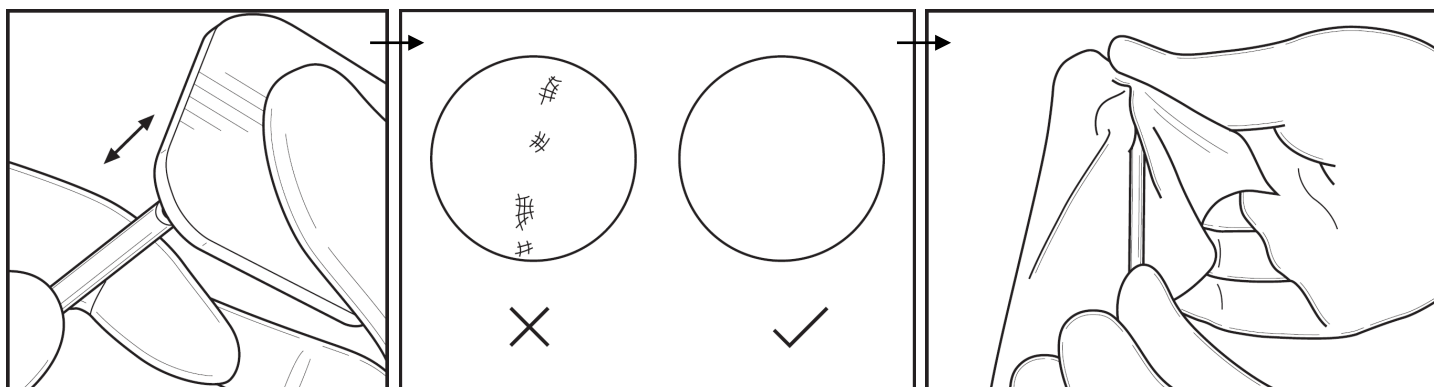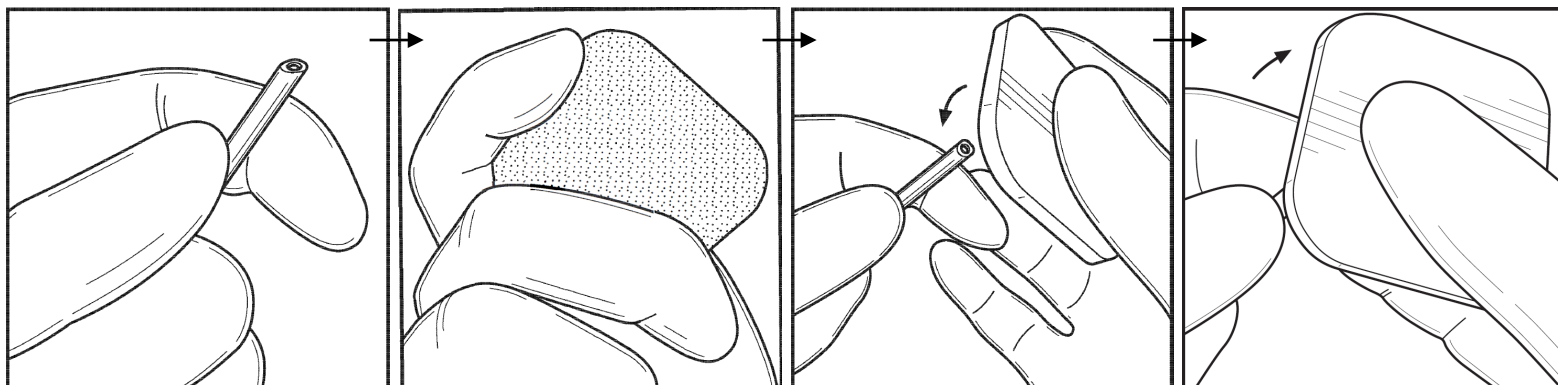

Opcionális

