

REF 6001

Pulēšanas paliktnis

Paredzētais lietojums

Pulēšanas paliktnis, kas paredzēts lietošanai ar cietiem endoskopiem, ir aprīkots ar pulēšanas virsmu, kas palīdz samazināt netīrumu daudzumu no lēcas.

Brīdinājumi

- Lietot tikai ar cietiem endoskopiem.
- NELIETOT uz ļoti karstām virsmām.
- NELIETOT kopā ar ķīmiskām vielām vai šķīdinātājiem.
- NEVEIKT nekādas izmaiņas paliktņiem.
- Pulēšanas laikā NEDRĪKST saliekt endoskopu

Incidenta gadījumā

Par visiem nopietniem starpgadījumiem, kas notikuši saistībā ar šo ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts attiecīgajai iestādei, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.

Iznīcināšana

Utilizējiet saskaņā ar medicīnas iestādes un pašvaldības norādījumiem.



Domicomed.com/eifu





Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
ASV
1.800.750.5300
www.domicomed.com

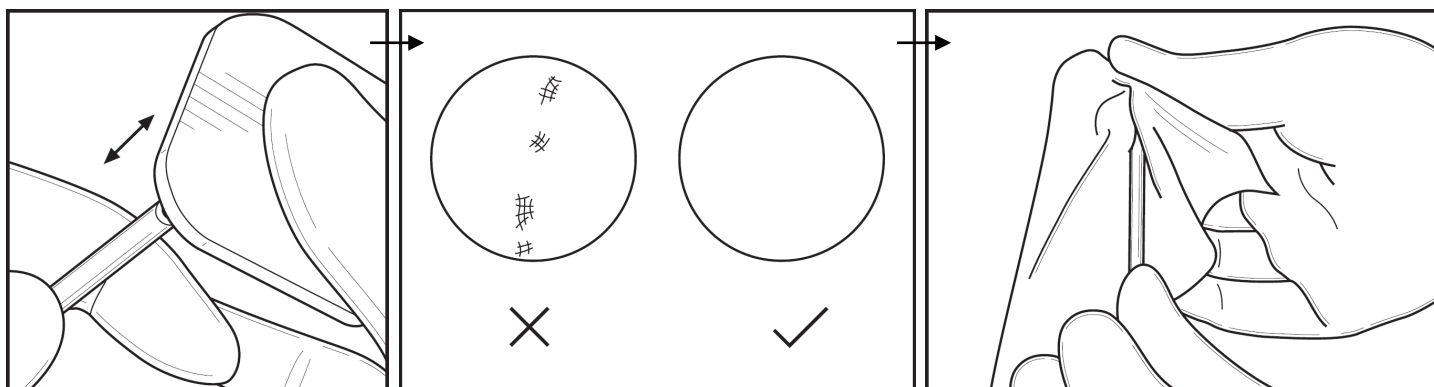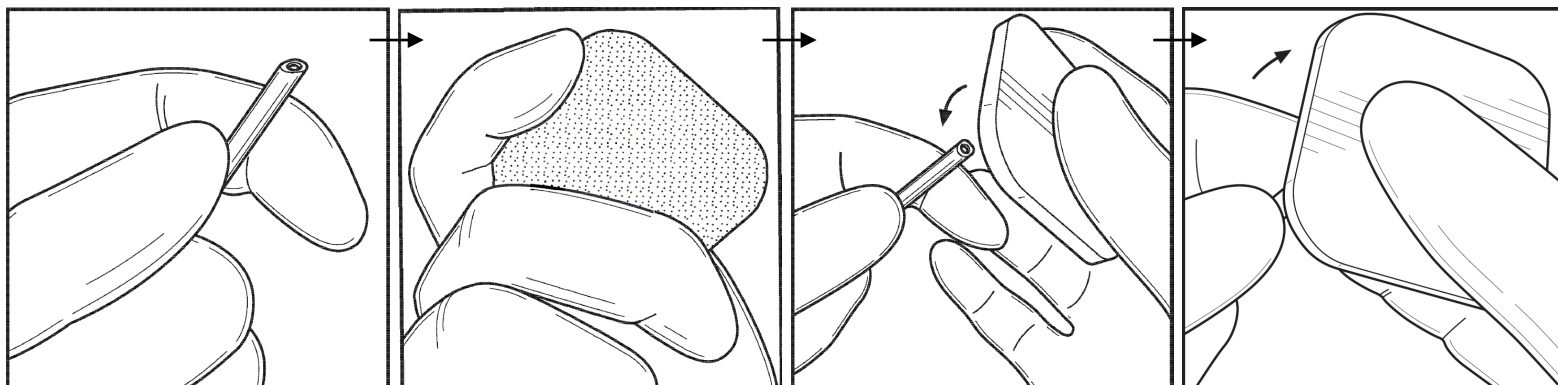

Cits variants

